

Instrucciones



Selection Programas




- 1 x = A₀ valor 1
- 2 x = A₀ valor 2
- 3 x = A₀ valor 3

Operacion

*) secado

Mal funcionamiento




de ahorro



intensivo



*) Optio

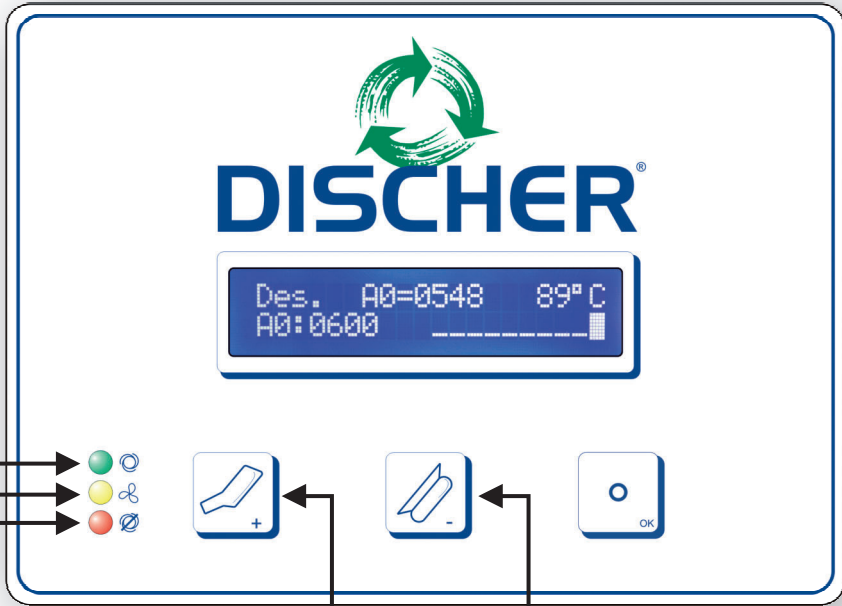

Instrumentación Médica S.A. DE C.V.
Calle Gral. Mariano Arista 54 Interior 24
Col. Argentina Poniente Miguel Hidalgo
Ciudad de México, D.F. 11230
Phone: +52 55437716
atencionalcliente@imedica.com.mx
<https://imedica.company/>

DISCHER Technik GmbH
Fuhr 4-6 • D- 42781 Haan
Tel: +49 (0) 2104 2336 0
Fax: +49 (0) 2104 2336 99
info@discher.de
www.discher.de

